


Répertoire: **Table de résultats**
 Ouvrir: **Auto XY** **Auto Y** **Piéc** **Texte** **Curseur** **Pics** **Optimiser** **Séparer** **Transmittance** **Ligne de base** **a-b** **Différence** **Normalisation** **Lisser**

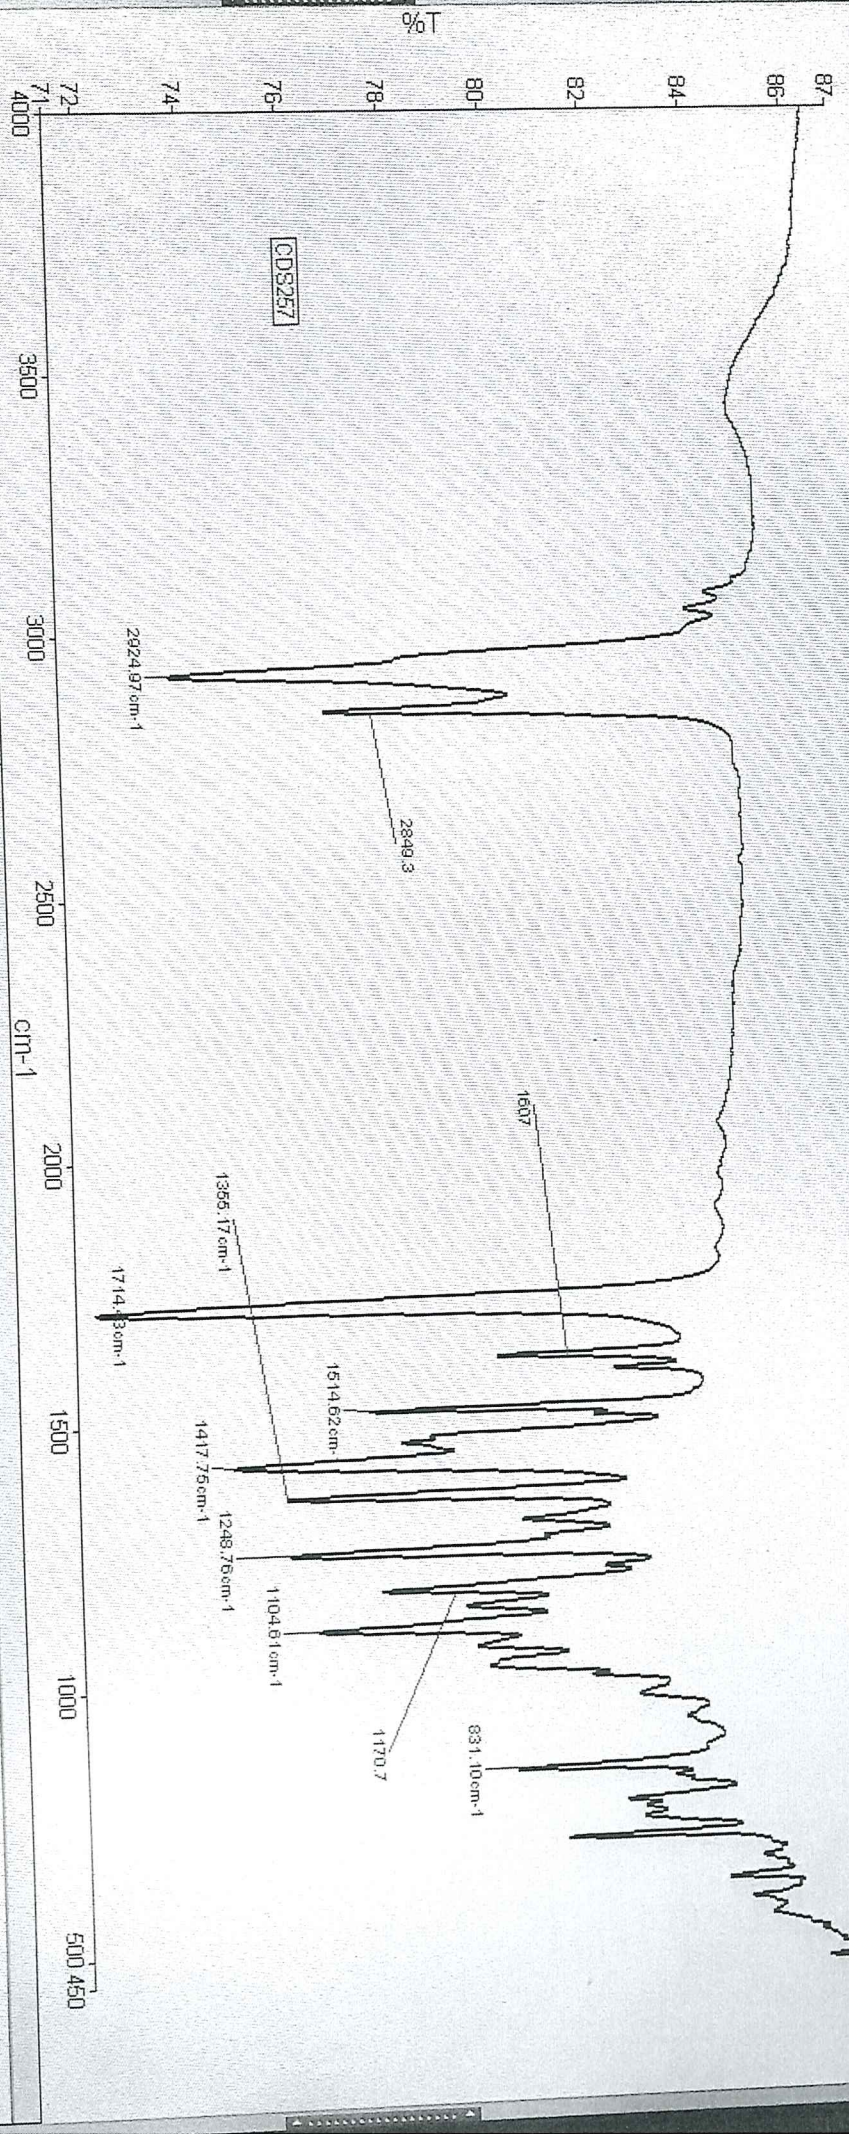

Nom	Description
Administrato 26_1	échantillon 026 Par Administrato Date mardi, ...

Paramétrage - Nom automatique: **Administrato 26_1**
 Paramétrage - Acquisition des données: **Administrato 26_1**
 Paramétrage - Triplet du faisceau: **Administrato 26_1**
 Paramétrage - Avancé: **Administrato 26_1**
 Paramétrage - Opérations de base: **Administrato 26_1**

Actions: **Restaurer Paramètres par défaut** **Charger/Sauver ...**

Paramètres: **Unités en abscisse** **Début (cm⁻¹)** **Fin (cm⁻¹)** **%T**
 Paramètres d'analyse: **Résolution (cm⁻¹)** **Echantillon** **Intervalle des données** **Accumulations**
 Paramètres d'analyse: **4** **Analyses**

6.32 mm (interne) en attente **6.32 mm (interne)** **6.32 mm (interne)** **6.32 mm (interne)**